



Kapsch Bellaphon GW

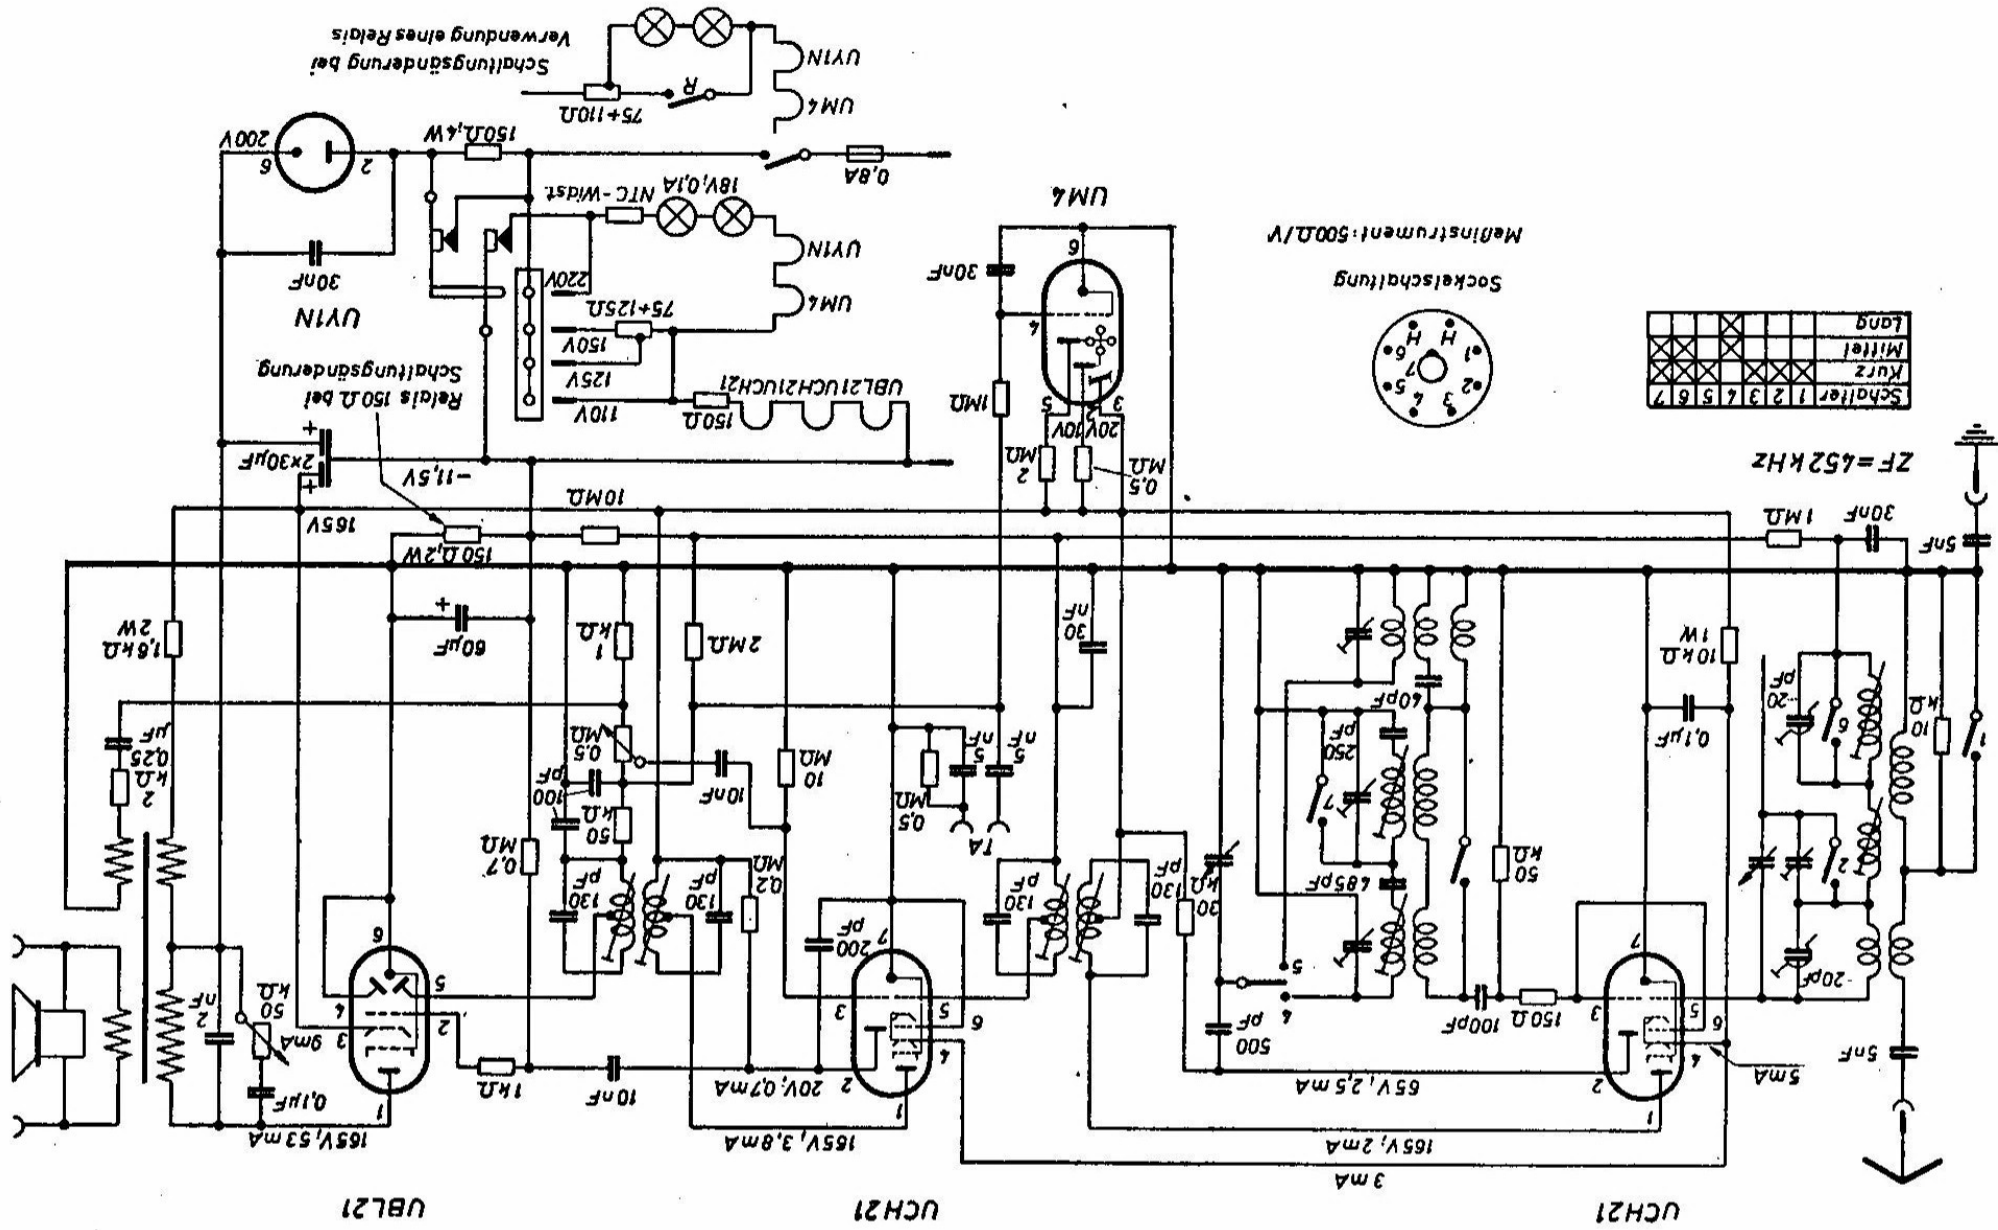

Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Kurz	×	×	×	×	×	×	×
Mittel	×	×	×	×	×	×	×
Lang	×	×	×	×	×	×	×



Sockettschaltung
Meßinstrument: 500Ω/V

Schaltungsänderung bei Verwendung eines Relais

Relais 150Ω bei Schaltungsänderung

UBL21

UCH21

UCH21